




**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**

07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1



Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, <http://www.szpitalwyszkow.pl/>

Wyszaków, dnia 22 lipca 2022 r.

DEZ/Z/341/ZP-33/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp w przedmiocie „Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Ciąg Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszakowie” na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę nr 1132/2021, nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-33/2022.

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SWZ, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie 1 dotyczy pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją przechyłu bocznego w zakresie +/- 20°? Wartość zaproponowanego przechyłu bocznego jest bezpieczna dla pacjenta i pozwala na wykonanie wszystkich zabiegów ginekologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 dotyczy pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją oparcia pleców w zakresie – 45° do 75°mm? Zaproponowany zakres pozwala w pełni wykorzystać stół przy zabiegach ginekologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 dotyczy pkt. 33 i 34

Czy Zamawiający dopuści kolumnę posiadającą w górnej części gumową, harmonijkową osłonę? Zaproponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane w większości stołów operacyjnych i nie wpływa na pracę operatorów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Dotyczy Łóżko porodowe:

- a) Pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytami umożliwiającymi montowanie akcesoriów zamiast „suwnic”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- b) Pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez półki na narzędzia i dopuści zaoferowanie małego wózka instrumentowego? Takie rozwiązanie jest naszym zdaniem lepsze od wymaganego z uwagi na fakt iż daje większą możliwość adaptacji w zależności od rozwoju akcji porodowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- c) Pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dedykowanymi uchwytami zamiast „suwnic”

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na Pytanie nr 4.

- d) Pkt. 21. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne opuszczane wzdłuż ramy leża, poniżej powierzchni materaca? Takie rozwiązanie jest wygodniejsze od wyciąganych oparć bocznych

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- e) Pkt. 23. Czy Zamawiający w pk 22 wymaga zaoferowania do łóżka porodowego ramy do pozycji kucznej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

- f) Pkt. 24. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wadze 165kg ? Jest to parametr lepszy od wymaganego z uwagi na fakt iż łatwiej jest przemieszczać łóżko lżejsze.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

- g) Pkt. 25. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją części pleców w zakresie od 0 do 75 stopni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

- h) Pkt. 26. Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z regulacją Trendelenburga w zakresie 0 -12

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

- i) Pkt. 27. Czy Zamawiający w pk 27 wymaga zaoferowania łóżka porodowego z funkcją regulacji

- j) pochylenia sekcji nożnej w zakresie : 0 – 16 stopni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

- k) Pkt. 28. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją w zakresie 580 – 955 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- l) Pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 1300mm w pozycji fotela?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- m) Pkt. 35. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 780mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

- n) Pkt. 37. Czy Zamawiający ma na myśli klasę szczelności IPX 6 ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 5

Dotyczy Wózek zabiegowy 2-blatowy:

- a) Pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści wózek z blatami ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- b) Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści wózek z blatami ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

c) Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 830mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

d) Pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 625mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

e) Pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści wózek bez deklaracji zgodności CE? Zgodnie z wytycznymi PE dotyczącymi wyrobów medycznych tego typu sprzęt nie jest wyrobem medycznym i nie wydaje się dla niego deklaracji CE.

Odpowiedź:

Jeżeli produkt został wprowadzony do obrotu w innych krajach członkowskich UE lub EFTA wówczas nie wymaga zgłoszenia do RWM.

f) Pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści wózek bez deklaracji zgodności CE i wpisu do RWM? Zgodnie z wytycznymi PE dotyczącymi wyrobów medycznych tego typu sprzęt nie jest wyrobem medycznym i nie wydaje się dla niego deklaracji CE jak również nie podlega on rejestracji w RWM

Odpowiedź:

Jeżeli produkt został wprowadzony do obrotu w innych krajach członkowskich UE lub EFTA wówczas nie wymaga zgłoszenia do RWM.

Pytanie 6

Dotyczy Lampa operacyjna:

a) Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści lampę w formie dwóch współśrodkowych okręgów z wolną przestrzenią pomiędzy nimi gwarantującą swobodny przepływ z nawiewu laminarnego? Nadmieniamy iż to rozwiązanie jest lepsze od wymaganego, ponieważ gwarantuje najniższy współczynnik zakłóceń przepływu laminarnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

b) Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę o maksymalnym poborze mocy przez lampę główną 150W oraz satelitarną 110W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

c) Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści lampę ze sterylizowanym uchwytem zlokalizowanym nie w geometrycznym środku czaszy lampy a w jego pobliżu na łączniku okręgu wewnętrznego i zewnętrznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

d) Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści lampę w formie dwóch współśrodkowych okręgów z wolną przestrzenią pomiędzy nimi gwarantującą swobodny przepływ z nawiewu laminarnego? Nadmieniamy iż to rozwiązanie jest lepsze od wymaganego, ponieważ gwarantuje najniższy współczynnik zakłóceń przepływu laminarnego

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie nr 6.

e) Pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej w trzech stopniach w zakresie 3700/4400 /5100 K?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

f) Pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją średnicy pola w zakresie 20 – 37 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

g) Pkt. 21. Czy Zamawiający dopuści lampę bez zewnętrznych uchwytów, które znacznie zakłócają nawiew laminarny?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

h) Pkt. 28. Czy Zamawiający dopuści oświetlenie ENDO w kolorze zielonym w formie okręgu bez regulacji natężenia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

i) Pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści lampy z możliwością synchronizowania, gdzie synchronizacji podlegają wszystkie funkcje lampy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

j) Pkt. 33. Czy Zamawiający dopuści lampę w formie dwóch współśrodkowych okręgów z wolną przestrzenią pomiędzy nimi gwarantującą swobodny przepływ z nawiewu laminarnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

k) Nadmieniamy iż to rozwiązanie jest lepsze od wymaganego, ponieważ gwarantuje najniższy współczynnik zakłóceń przepływu laminarnego

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na punkt 33

l) Pkt. 35. Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej w trzech stopniach w zakresie 3700/4400 /5100 K?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

m) Pkt. 36. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją średnicy pola w zakresie 20 – 32 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

n) Pkt. 48. Czy Zamawiający dopuści oświetlenie ENDO w kolorze zielonym w formie okręgu bez regulacji natężenia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

o) Pkt. 51. Czy Zamawiający dopuści lampy z możliwością synchronizowania, gdzie synchronizacji podlegają wszystkie funkcje lampy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

p) Pkt. 52. Czy Zamawiający wymaga aby obydwie kopuły lampy posiadały system elektronicznej zmiany szerokości pola oraz intensywności oświetlenia regulowanej sterylizowanym uchwytem na czaszy lampy z dotykową funkcją wyboru pomiędzy regulacją szerokości pola a intensywnością oświetlenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

q) Czy Zamawiający wymaga aby lampa posiadała laserowy wskaźnik który informuje o aktualnie wybranej funkcji sterylizowanego uchwyty regulacyjnego w postaci odpowiednich diagramów wyświetlanych na powierzchni blatu stołu wokół pola operacyjnego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 7

Dotyczy Meble ze stali nierdzewnej:

- a) Pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy meble medyczne gdzie wszystkie elementy składowe korpusu za wyjątkiem części plecowej wykonane są w technologii podwójnej blachy stalowej z wewnętrznym wypełnieniem w formie „plastra miodu” co wyklucza jakąkolwiek możliwość uwypuklania blachy na tylnej ścianie i eliminuje potrzebę stosowania jakichkolwiek wzmocnień? Czy Zamawiający dopuści meble wykonane w technologii podwójnej blachy stalowej z wewnętrznym wypełnieniem w formie „plastra miodu” gdzie elementy korpusu są częściowo skręcane, częściowo spawane, tak że nie są widoczne żadne nity, śruby ani na zewnątrz ani wewnątrz szafki? Nadmieniamy iż taka konstrukcja gwarantuje większą sztywność i stabilność niż tylko spawana konstrukcja z pojedynczej blachy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- b) Pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści meble z regulacją wysokości półek co 25 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- c) Pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści meble posadowione na cokołach które są uszczelnione do podłogi dzięki czemu gwarantują łatwiejsze utrzymanie w czystości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pytanie 8

Dotyczy Stół operacyjny do operacji ginekologicznych:

- a) Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z napędem elektromechanicznym z funkcją flex i reflex ustawianą przy pomocy dwóch przycisków?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

- b) Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści stół z pilotem i panelem aktywowanym poprzez naciśnięcie wybranej funkcji bez dodatkowych przycisków aktywujących?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

- c) Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści stół z pilotem i panelem aktywowanym poprzez naciśnięcie wybranej funkcji bez dodatkowych przycisków aktywujących?

Odpowiedź:

Zgodnie SWZ

- d) Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści stół o zakresie regulacji 540 – 1030mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

- e) Pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści regulację przechyłów bocznych w zakresie +/-20 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- f) Pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców w zakresie -40 stopni do +70 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- g) Pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści regulację pozycji Flex do 220 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- h) Pkt. 29. Czy Zamawiający dopuści stół blokowany w poprzez uniesienie kół dzięki czemu stół osiada stabilnie na podstawie?

Odpowiedź:

Dopuszczamy z zachowaniem wymaganej regulacji wysokości

- i) Pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści stół blokowany w poprzecz uniesienie kół dzięki czemu stół osiada stabilnie na podstawie?

Odpowiedź:

Dopuszczamy z zachowaniem wymaganej regulacji wysokości

- j) Pkt. 33. Czy Zamawiający dopuści stół z kolumną i podstawa ze stali nierdzewnej wyposażony w gumową osłonę przegubów w górnej części kolumny ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- k) Pkt. 34. Czy Zamawiający dopuści stół z kolumną i podstawa ze stali nierdzewnej wyposażony w gumową osłonę przegubów w górnej części kolumny ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pkt. 39. Czy Zamawiający dopuści stół bez opcji przystosowania do systemu integracji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 9

Dotyczy Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o następujących parametrach:

Konstrukcja szafki ze stali lakierowanej proszkowo z korpusem szafki wykonanym z płyty pokrytej tworzywem sztucznym.

Cztery podwójne koła o średnicy 75 mm w tym wszystkie cztery z hamulcami

Blat szafki z płyty pokrytej tworzywem sztucznym z dodatkową nakładką z ABS. Nakładka wyprofilowana z podwyższonymi brzegami

Pomiędzy korpusem szafki a blatem wolna przestrzeń na rzeczy pacjenta z bocznymi zabezpieczeniami zapobiegającymi przed zsuwaniem rzeczy na boki

Stolik boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej, z funkcją obrotu na wysięgniku, chowany pod blat szafki. Stolik po wsunięciu pod blat szafki może być wykorzystany jako półka.

Szafka wyposażona w dwie szuflady z frontami wykonanymi z ABS

Szerokość korpusu 475 mm , głębokość 600 mm, wysokość 900 mm

Wymiar stolika 480 x 380 mm

Zakres regulacji stolika 780 – 1050 mm

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 10

Dotyczy Myjnia chirurgiczna bezdotykowa:

- a) Pkt.8. Czy Zamawiający dopuści myjnię bez deklaracji zgodności CE? Zgodnie z wytycznymi PE dotyczącymi wyrobów medycznych tego typu sprzęt nie jest wyrobem medycznym i nie wydaje się dla niego deklaracji CE .

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

- b) Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści myjnię bez deklaracji zgodności CE i wpisu do RWM? Zgodnie z wytycznymi PE dotyczącymi wyrobów medycznych tego typu sprzęt nie jest wyrobem medycznym i nie wydaje się dla niego deklaracji CE jak również nie podlega wpisowi do RWM

Odpowiedź:

Deklaracja CE obowiązkowo, jeżeli produkt został wprowadzony do obrotu w innych krajach członkowskich UE lub EFTA wówczas nie wymaga zgłoszenia do RWM.

Pytanie 11

KOLUMNA CHIRURGICZNA

Czy Zamawiający dla kolumny chirurgicznej dopuści półki o wymiarach 470 x 450 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: Załącznik nr 1 1. Łóżko porodowe:

- a) Punkt 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, którego rama wyposażona jest w 4 kółka o średnicy 150 mm, która nie jest obudowana pokrywą z tworzywa ABS?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

- b) Punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe w którym ruchy sekcji pleców i siedziska wykonywane są za pomocą pilota przewodowego, natomiast pozycja Trendelenburga realizowana jest mechanicznie, za pomocą sprężyny gazowej w blokadę. Oferowany model łóżka wyposażony jest również w panele sterujące ulokowane w barierkach bocznych oraz sterownik nożny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- c) Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, w którym materace wykonane są z pianki poliuretanowej w pokrowcach. Pokrowce wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Pokrowiec niepalny zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (kolorystyka do uzgodnienia)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- d) Punkt 12 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe bez półki z tworzywa ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- e) Punkt 24 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe o wadze 160 kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

- f) Punkt 26 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe z regulacją Trendelenburga 12 stopni i Anty Trendelenburga 5 stopni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

- g) Punkt 28 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe z regulacją wysokości leża w zakresie 616-985mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- h) Punkt 29 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe z regulacją sekcji nóg 0-570mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- i) Punkt 34 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe o długości sekcji nóg 600mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

j) Punkt 35 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko porodowe o szerokości leża 855mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

k) Punkt 37 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko porodowe z ochroną IPX4?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

l) Punkt 38 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko porodowe z ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym – klasa II, typ B?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 13

Stół operacyjny do operacji ginekologicznych:

a) punkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z głównym napędem elektrohydraulicznym, za wyjątkiem przesuwu wzdłużnego blatu, który realizowany jest przy pomocy układu elektromechanicznego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

b) punkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z mechanicznym blokowaniem stołu do podłoża?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

c) punkt 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez pilota nożnego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

d) punkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu 680-1080 mm (bez materacy)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

e) punkt 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie od -50stopni do +55 stopni ale bez wzdłużnego odsunięcia od segmentu plecowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

f) punkt 25 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym elementy konstrukcyjne blatu są gięte i spawane i zapewniają bardzo wysoką stabilność stołu? Jest to rozwiązanie stosowane przez większość producentów stołów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

g) punkt 28-30 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny mobilny, z podstawą w kształcie litery T, posiadającej 3 koła jezdne? Dwa koła o wymiarach 125 mm, a trzecie, które jest równocześnie kołem obrotowym, o wymiarze 80 mm? W oferowanym modelu stołu blokowanie kół odbywa się mechanicznie, za pomocą 4 wysuwanych stopek.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

h) punkt 39 tabeli: Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z wymogu współpracy stołu z systemem integracji Sali operacyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stół operacyjny bez integracji z systemem Sal operacyjnych

Pytanie 14

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów na przedmiotowe zadanie. Zakres przewidzianych prac, jego złożoność oraz wydłużony czas na pozyskanie wyceny wyposażenia specjalistycznego uniemożliwia nam rzetelną wycenę w przedmiotowym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dołącza przedmiary.

Pytanie 15

Dotyczy załącznika nr 1 – OPZ oraz załącznika nr 1A – Dokumentacja projektowa Pozycja 2 – Kolumna chirurgiczna

a) pkt 11

Czy Zamawiający dopuści kolumnę z konsolą wykonaną z aluminium malowanego na kolor 9003 (biały) z palety RAL dodatkowo pokrytą powłoką antybakteryjną z elementami wykonanymi z tworzywa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

b) pkt 18 i 19

Czy Zamawiający dopuści kolumnę z konsolą o szerokości 298 i głębokości 280 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

c) pkt 23

Czy Zamawiający dopuści kolumnę z gniazdami elektrycznymi zlicowanymi z powierzchnią ścianki z klapką ochronną wystającą z ścianki, z sygnalizacją kontrolną LED?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

d) pkt 34

Czy Zamawiający dopuści kolumnę bez sygnalizatora LED odblokowania hamulca, który jest zbędna, ponieważ przy wciśnięciu danego przycisku odpowiadającego za konkretny przegub hamulec zostanie zwolniony?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

e) pkt 37

Czy Zamawiający dopuści kolumnę z szufladą wyposażoną w opływowy uchwyt do jej otwierania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Dotyczy załącznika nr 1 – OPZ oraz załącznika nr 1A – Dokumentacja projektowa Pozycja 4 – Lampa operacyjna

a) pkt 6

Czy Zamawiający dopuści lampy w których każda z nich posiada 51 diod wymienianych pojedynczo co zmniejsza koszty eksploatacji i ewentualnych napraw?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

b) pkt 7


Czy Zamawiający dopuści regulację średnicy pola operacyjnego w obu kopułach z panelu dotykowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

c) pkt 13

Czy Zamawiający dopuści czaszę w kształcie litery Y wpisanej w okrąg o łatwej do czyszczenia budowie składającej się z 3 segmentów?

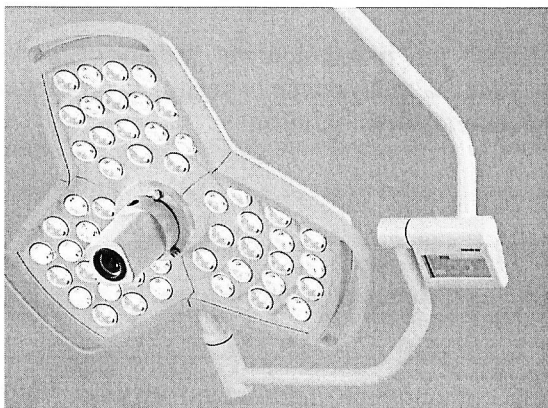

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

d) pkt 15 i 35

Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej w pięciu stopniach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

e) pkt 16

Czy Zamawiający dopuści regulację średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym w zakresie 18-28 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

f) pkt 21

Czy Zamawiający dopuści kopułę lampy wyposażonej w trzy uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lampy niezależnie od jej położenia? Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

g) pkt 26

Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia światła w zakresie 5-100% poprzez panel umieszczonym na ramieniu lampy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

h) pkt 27

Czy Zamawiający dopuści włącznik lampy umieszczony tylko na panelu sterowania zamocowanym na ramieniu kolumny?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

i) pkt 28


Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w dedykowany tryb oświetlenia endo (realizowane przez wszystkie diody) ze stałym natężeniem równym 5% natężenia maksymalnego, co jest wystarczające do zapewnienia oświetlenia otoczenia podczas małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych oraz uruchamiany jednym przyciskiem na panelu sterowania umieszczonym na ramieniu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

j) pkt 33

Czy Zamawiający dopuści czaszę w kształcie litery Y wpisanej w okrąg o łatwej do czyszczenia budowie składającej się z 3 segmentów?

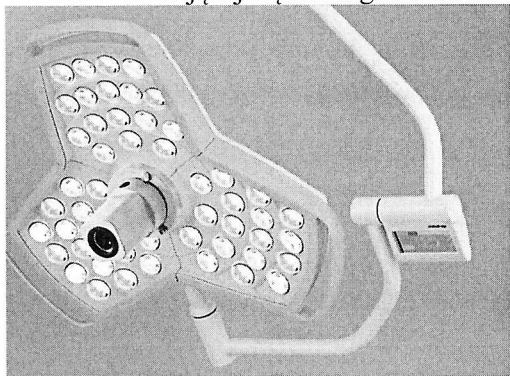

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

k) pkt 36

Czy Zamawiający dopuści regulację średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym w zakresie 18-28 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

l) pkt 38

Czy Zamawiający dopuści głębokość oświetlenia L1 + L2 w zakresie 120 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

m) pkt 46

Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia światła w zakresie 5-100% poprzez panel umieszczonym na ramieniu lampy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

n) pkt 47

Czy Zamawiający dopuści włącznik lampy umieszczony tylko na panelu sterowania zamocowanym na ramieniu kolumny?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

o) pkt 48

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w dedykowany tryb oświetlenia endo (realizowane przez wszystkie diody) ze stałym natężeniem równym 5% natężenia maksymalnego, co jest wystarczające do zapewnienia oświetlenia otoczenia podczas małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych oraz uruchamiany jednym przyciskiem na panelu sterowania umieszczonym na ramieniu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

p) pkt 50

Czy Zamawiający dopuści wielkość napromieniowania o wartości maksymalnie 540 W/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

q) pkt 53

Czy Zamawiający dopuści lampy bez pilota bezprzewodowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 17

Dotyczy załącznika nr 1 – OPZ oraz załącznika nr 1A – Dokumentacja projektowa Pozycja 7 – Stół operacyjny do operacji ginekologicznych

a) pkt 4

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pilotem bez podświetlenia z czytelnymi i dużymi piktogramami ułatwiającymi obsługę stołu operacyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

b) pkt 7

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pilotem wyłączającym się po 60 sekundach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

c) pkt 13

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 498 do 1000 mm (zakres wysokości liczony bez materacy)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

d) pkt 14

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją przechyłu wzdłużnego w zakresie $\pm 26^{\circ}$?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

e) pkt 15

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją przechyłu bocznego w zakresie $\pm 21^{\circ}$?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

f) pkt 17

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie od -90° do 45° ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

g) pkt 20

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym blatu 320 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

h) pkt 29 i 30

Czy Zamawiający dopuści system blokowania stołu operacyjnego przez chowanie kół w podstawę? Na czas operacji stół opiera się stabilnie, całą podstawą dzięki nie wymagana jest kompensacja nierówności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

i) pkt 33 i 34

Czy Zamawiający dopuści obudowę kolumny z tworzywową, harmonijkową osłoną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

j) pkt 39

Czy Zamawiający dopuści stół bez przystosowania do sterowania integracją? Obecnie w nowych modelach stołów nie stosuje się sterowania zewnętrznymi systemami z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta i operatora.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Załącznik nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych

10. Stanowisko do resuscytacji

a) Ad. Pkt. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z natężeniem promieniowania podczerwonego na powierzchni materacyka mniejszego lub równego 30 mW/cm²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

b) Ad. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji, w którym mikroprocesorowy system kontroli i regulacji ręcznej temperatury mocy grzania odbywa się co 10% i jednokolorowy wyświetlacz temperatury?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

c) Ad. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym alarmy akustyczne i optyczne niedogrzenia i przegrzania uruchomione zostają poniżej 1 st. C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

d) Ad. Pkt. 18.

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie bez wbudowanej w głowicę ogrzewacza lampy do fototerapii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

e) Ad. Pkt. 20.

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie z mocą kwarcowego promiennika podczerwieni 600W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19

Załącznik nr 3 Umowa § 15 ust. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 20

Załącznik nr 3 Umowa § 18 ust. 4

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 21

Dotyczy: 8. Zabudowa medyczna

a) Czy w pkt. 28 tabeli Zamawiający dopuści certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

b) Dotyczy pkt. 29 tabeli: Zabudowy meblowe opisane przez Zamawiającego nie posiadają składowych elementów mechanicznych ani elektrycznych, zatem nie wymagają one deklaracji zgodności CE. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przedstawienia deklaracji zgodności CE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rezygnację z wymogu przedstawienia deklaracji zgodności CE, jednocześnie Zamawiający zaznacza, że powierzchnie muszą być zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne stosowane w obiektach służby zdrowia.

- c) Dotyczy pkt.30 tabeli: Meble opisane przez Zamawiającego nie są produktem wymagającym wpisu lub zgłoszenia do RWM. Czy Zamawiający zrezygnuje zatem z wymogu przedstawienia dokumentów wpisu lub zgłoszenia do RWM?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

Pytanie 22

Dotyczy: 11. Myjnia chirurgiczna bezdotykowa

Dotyczy pkt. 9 tabeli: Myjnia opisana przez Zamawiającego nie jest produktem wymagającym wpisu lub zgłoszenia do RWM. Czy Zamawiający zrezygnuje zatem z wymogu przedstawienia dokumentów wpisu lub zgłoszenia do RWM?

Odpowiedź:

Jeżeli produkt został wprowadzony do obrotu w innych krajach członkowskich UE lub EFTA wówczas nie wymaga zgłoszenia do RWM.

Pytanie 23

Dotyczy: Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przedłużenie terminu składania ofert z uwagi na czasochłonne przygotowanie oferty oraz przypadające przed terminem złożenia dni wolne od pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert jest do dnia 01.08.2022 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.08.2022 r. o godz. 10.15

Pytanie 23

Dotyczy: 1- Łóżko porodowe

- a) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez półki z tworzywa ABS zaprojektowanej jako półka na narzędzia chirurgiczne potrzebne w czasie porodu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- b) Czy w pkt. 20 Zamawiający dopuści pilot sterujący regulacją wysokości i ułożeniem sekcji pleców?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

- c) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wadze 123 kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

- d) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją sekcji pleców : 0-70°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- e) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające przechył Trendelenburga i anty-Trendelenburga 14°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- f) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające regulację sekcji ud 0-14°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- g) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające regulowaną wysokość leża w zakresie 580-900 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

h) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające długość całkowitą 2000 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

i) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości leża 850 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

j) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z wysokością regulowaną przy pomocy systemu kolumnowego, sterowanego siłownikiem elektrycznym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

k) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wadze 130kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

l) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające przechył Trendelenburga i anty-Trendelenburga 15°?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

m) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające regulację sekcji ud 0-15°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

n) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające regulowaną wysokość leża w zakresie 640-1030 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

o) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez regulacji sekcji nóg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

p) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości 153 cm bez segmentu nożnego?

Odpowiedź:

Dopuszczamy z zastrzeżeniem, że całkowita długość łóżka nie może być niższa niż 210 cm

q) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości 144 cm bez segmentu nożnego?

Odpowiedź:

Dopuszczamy z zastrzeżeniem, że całkowita długość łóżka nie może być niższa niż 210 cm

r) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości z segmentem nożnym 204 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert jest do dnia 01.08.2022 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.08.2022 r. o godz. 10:15.

Sporządziła:

Joanna Wilk

e-mail: zp@szpitalwyszkow.pl

